

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Nst Ve Ekg Kağıdı Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

Hasan ASLAN
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|------|------------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | NST KAĞIDI Z KATLI 100 MM X 150 MM | 200 | Adet | | |
| 2 | EKG KAĞIDI Z KATLI 110 MM X 140 MM | 50 | Adet | | |
| | | | | Toplam | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:5.03.2020 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

140mmx110mm Z KATLI EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Satın alınacak EKG kağıdı, Nihon Kohden marka CARDİOFAX-S Model cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen EKG kağıdı her 14 cm'de bir Z şeklinde katlanmış ve kolay koparılabilir özellikte olmalıdır.
3. Kağıt 10 cm eninde ve 30 mt uzunluğunda olmalıdır.
4. Yatay ve dikey hat çizgileri (Kare Desenli) olmalıdır.
5. Kağıt anılan marka cihazda sorunsuz kullanılabilmelidir.
6. Jelatin ambalaj içinde, su ve nem almayacak biçimde paketli olmalıdır.
7. Satın Alınacak EKG kağıtları numune üzerinden değerlendirileceğinden, firmalar birer adet numune vermelidir.

Emrah KILIÇOĞLU
Tıpın Kağıt Yetkilisi


COMMIEN CM 5000 D NST CİHAZI İÇİN;

NST KÂĞIDI Z KATLI 150X100 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ


1-ÜRÜN HASTANEMİZ MARSA EK HİZMET BİNASINDA KULLANILMAKTA OLAN
COMMIEN MARKA CM 5000 D MODEL NST CİHAZINA UYUMLU OLMALIDIR.

2-ÜRÜN HAVA VE NEM GEÇİRMEMEYECİK BİÇİMDE JELATİN KAPLI OLMALIDIR.

3-AŞAĞIDA BELİRTİLEN GÖRSELDE BELİRTİLEN DESENDE, DESENLERİ KIRMIZI
RENK TONUNDA OLMALIDIR.

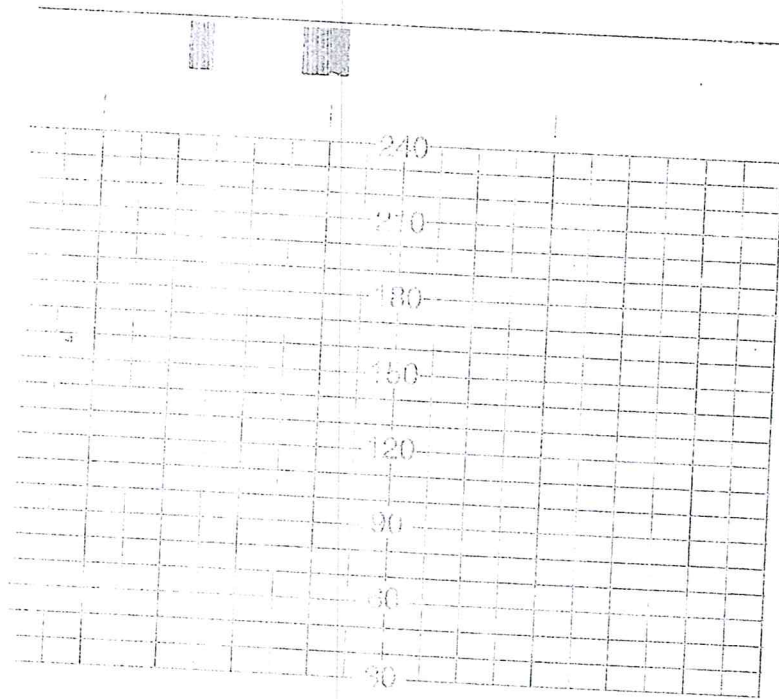

A technical drawing of a grid. The grid is 240 units wide and 240 units high. The dimensions are labeled on the right side of the grid: 240, 210, 180, 150, 120, 90, 60, 30.

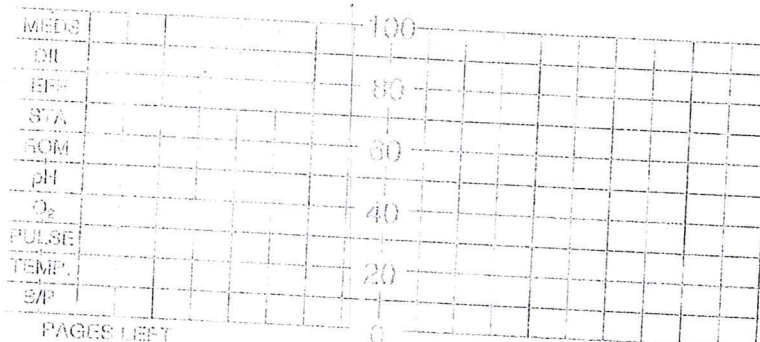

A technical drawing of a grid. The grid is 100 units wide and 100 units high. The dimensions are labeled on the right side of the grid: 100, 80, 60, 40, 20, 0. The grid is labeled with various parameters on the left side: MEDS, BIL, BEP, STA, ROM, pH, O₂, PULSE, TEMP., E/P. Below the grid, the text 'PAGES LEFT' is visible.

EMİNE TELESOĞLU
Tasarı Yayı Yetkilisi