

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Sfinkterotom 3 Lümenli 20mm Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ, 2.8*20MM	30	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:14.03.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

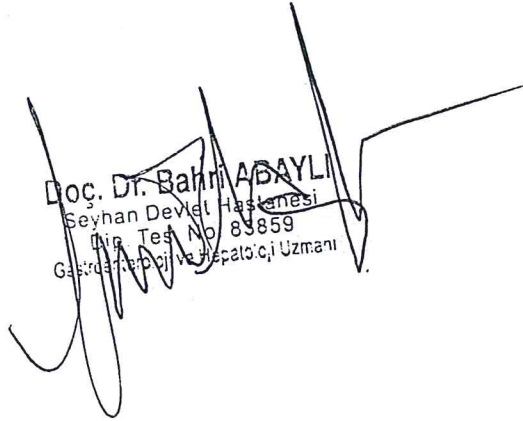
SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tel:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

SFİNKTEROTOM 3 LÜMENLİ 20 mm (ULTRATOME XL TRİPLE LUMEN)

1. Enjeksiyon, kesme teli ve kılavuz tel için 3 ayrı lümenli olmalıdır.
2. Kılavuz tel üzerinde iken enjeksiyon yapılabilir.
3. Distal ucu 5 mm ve 20 mm uzunluğunda ve radyopak olmalıdır.
4. Distal ucunun dış çapı 7Fr'den 5.5Fr'e doğru incelmeli, önceden yuvarlatılmış (tapered) olmalıdır.
5. Kateter uzunluğu 200 cm olmalıdır.
6. Bıçak uzunluğu 30 mm, kateter kısa burunlu olmalıdır.
7. 0.035 inç, 260 cm veya 450 cm kılavuz teller ile uyumlu olmalıdır.
8. Kılavuz tel değişim kanalı veya orifisi kateterin distal kısmında olmalıdır.
9. Kateter boyunca doktorun kılavuz tel kontrolünü sağlayacağı açık bir lümen bulunmalıdır.
10. Doktor kontrollü ERCP sistemi ile uyumlu olmalıdır.
11. Dış çapı 2.8 mm çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu olmalıdır.
12. Güvenli işlem için izole edilmiş olmalı.
13. Ürün tekli paketlerde muhafaza edilmiş olmalıdır.
14. Papillanın kontrolü sağlayan plastik Handle ve Handle üzerinde Aktif Kord bağlantısı bulunmalıdır.


Doç. Dr. Bahri ABAYLI
Seyhan Devlet Hastanesi
Diy. Tes. No: 83859
Gastroenteroloji ve Hepatoçöli Uzmanı